MANIFOLD AUTOMÁTICO Y SEMIAUTOMÁTICO
Gases Medicinais

CONFIGURAÇÕES GM
para cotação

arigmed®

Manifold Automático

Manifold Semiautomático

Indicar Equipes:

Número de Equipes: _____

Marque la ✓ opção desejada:

○ Manifold Automático

○ Manifold Semiautomático

Marca com ✓ o número de cilindros* cada banco:**

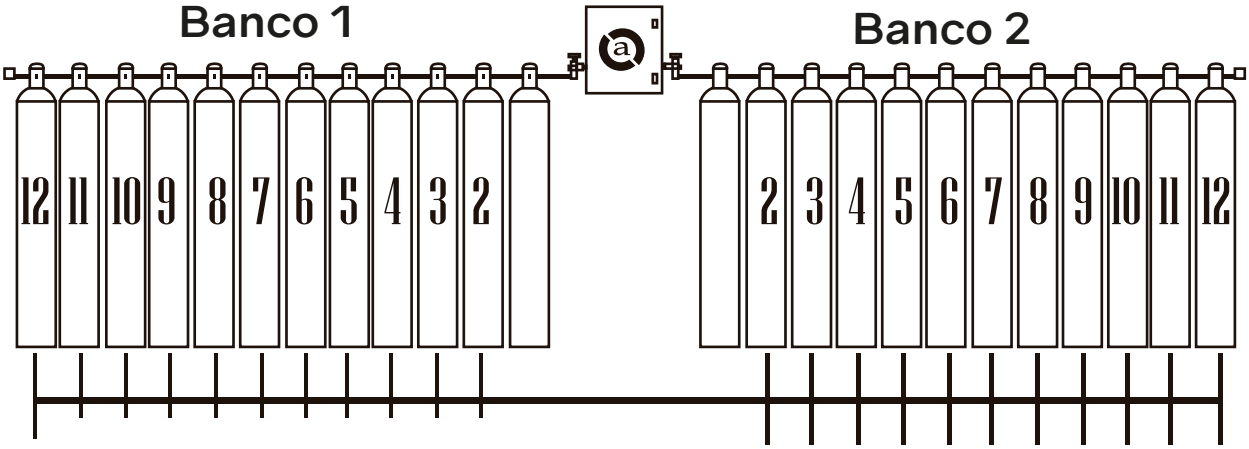

Cilindros*** cada banco: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

***Caso necessite de um manifold com capacidade para mais cilindros, consulte na área da vendas.

Marca com ✓ o Gas procurado:

○ *Ar Médico

○ *Óxido Nitroso

○ *Dióxido de Carbono

NOTA:

* Aplicam a cilindros de gás em alta Pressão.

**Aplicam a cilindros de gás em alta pressão ou sistema de cilindro criogênico Tipo de líquido para Deward

Marca com ✓ tipo de Gas e Líquido ou Gas:

○ **Oxigênio

○ **Azoto

Tipo

○ Gas

○ Líquido Deward

EQUIPO HÍBRIDO
Marca com ✓ em caso de aplicação:

○ **Manifold Híbrido

GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
www.arigmed.com Arigmed Medical Gas Equipments ventasmx@arigmed.com 779 79 69 370

Hecho en México

CERTIFICADOS World Register ISO 9001:2015 World Register ISO 13485:2016

MANIFOLD AUTOMÁTICO Y SEMIAUTOMÁTICO
Gases Medicinais

CONFIGURAÇÕES GM
para cotação

arigmed®

Barras para Manifold

Marque com ✓ a distância desejada entre os pontos de conexão nas barras:

X=30 cm ○ 30 cm (11.9 in)

X=15 cm ○ 15 cm (5.9 in)

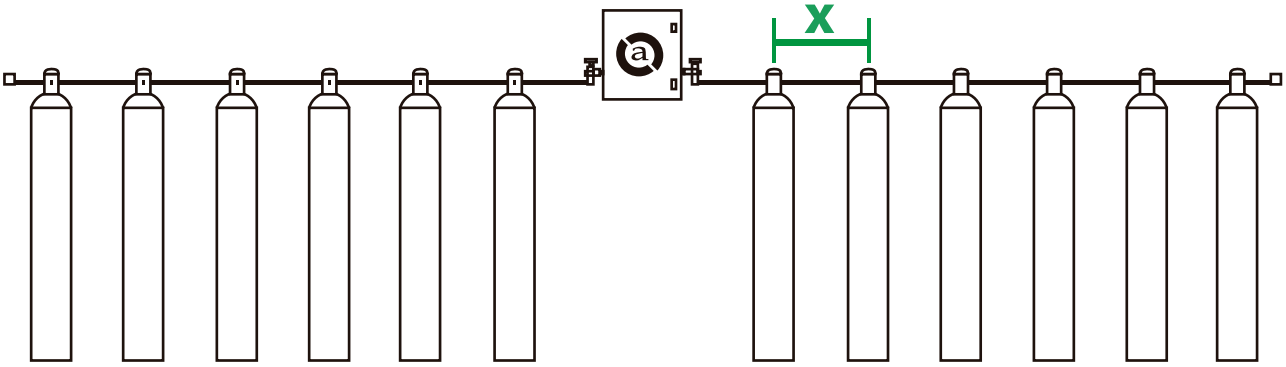

Banco 1 Banco 2

Marque com ✓ um se quiser um arranjo no esquadrão e indique as medidas:

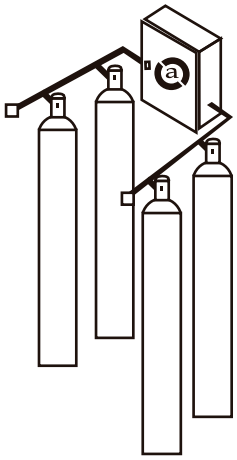

Vista Isométrica

○ Ângulo Dereito

Largo: _____ cm

61.1 cm

Comprimento: _____ cm

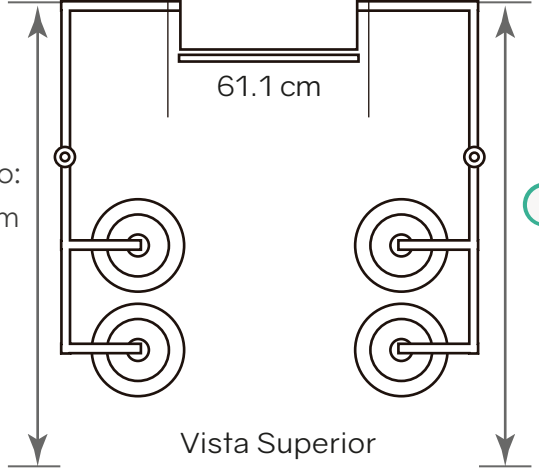

Vista Superior

○ Ângulo Esquerdo

Comprimento: _____ cm

GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com Arigmed Medical Gas Equipments ventasmx@arigmed.com 779 79 69 370

Hecho en México

CERTIFICADOS World Register ISO 9001:2015 World Register ISO 13485:2016