



Manifold Automático



Manifold Semiautomático

Indica las piezas deseadas:

Marca con una  la opción deseada:



No de piezas: \_\_\_\_\_




Manifold Automático



Manifold Semiautomático

Marca con una  el número de cilindros\*\*\* por bancada:

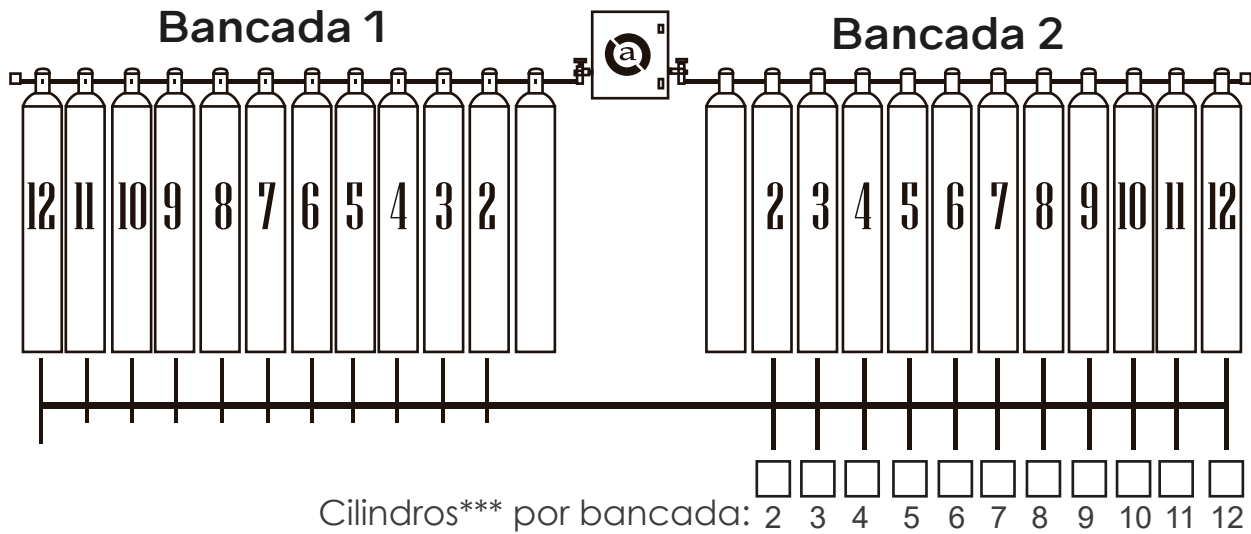

\*\*\*En caso de requerir un manifold con capacidad para más cilindros, favor de consultar al área de ventas.

Marca con una  elige el Gas deseado:

- \*Aire Médico
- \*Óxido Nitroso
- \*Dióxido de Carbono

Marca con una  la opción deseada y especificar el estado en gas o líquido:

- \*\*Oxígeno
- \*\*Nitrógeno
- Estado Gas
- Estado Líquido Deward

NOTA:

\*Aplican para cilindros de **gas en alta presión.**  
 \*\*Aplican para cilindros de **gas en alta presión** o **Sistema criogénico cilindros tipo líquido Deward**

**EQUIPO HÍBRIDO**


Marca con una  en caso de requerirlo:

- \*\*Manifold Híbrido




Barras para Manifold

Marca con una la distancia deseada entre los puntos de conexión en las barras:

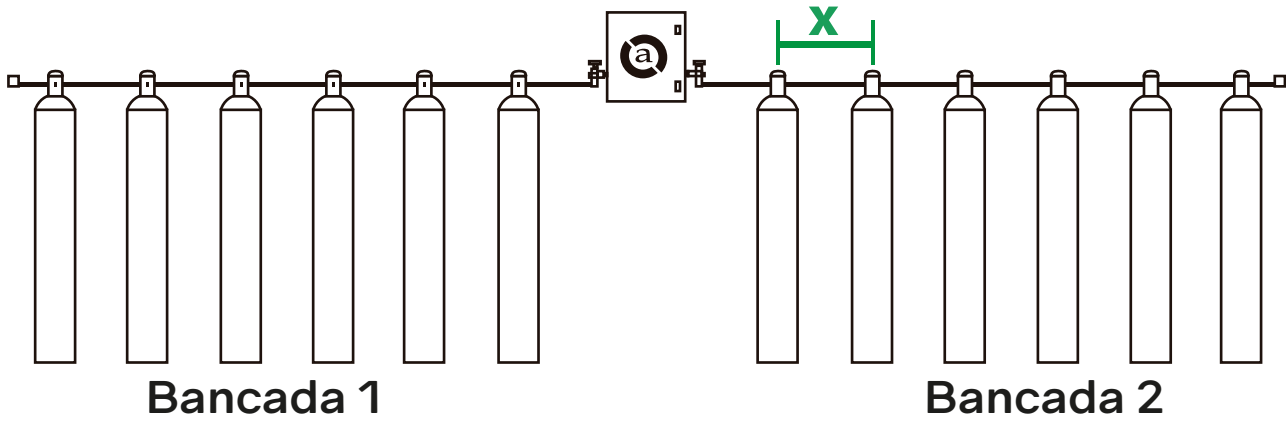

Marca con una si desea un arreglo en escuadra e indica las medidas:

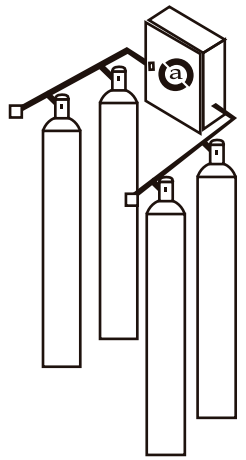

Vista Isométrica

